

ポンプ仕様変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は格別なるご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、このたび、弊社製品の資材につきまして下記のとおり変更いたしますのでお知らせ申し上げます。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

記


変更内容

- ① 形状変更
- ② ポンプの仕様 (バネ部分の色：半透明→白色)
※吐出量に変更はございません


変更理由

ポンプメーカーの仕様変更

従来品

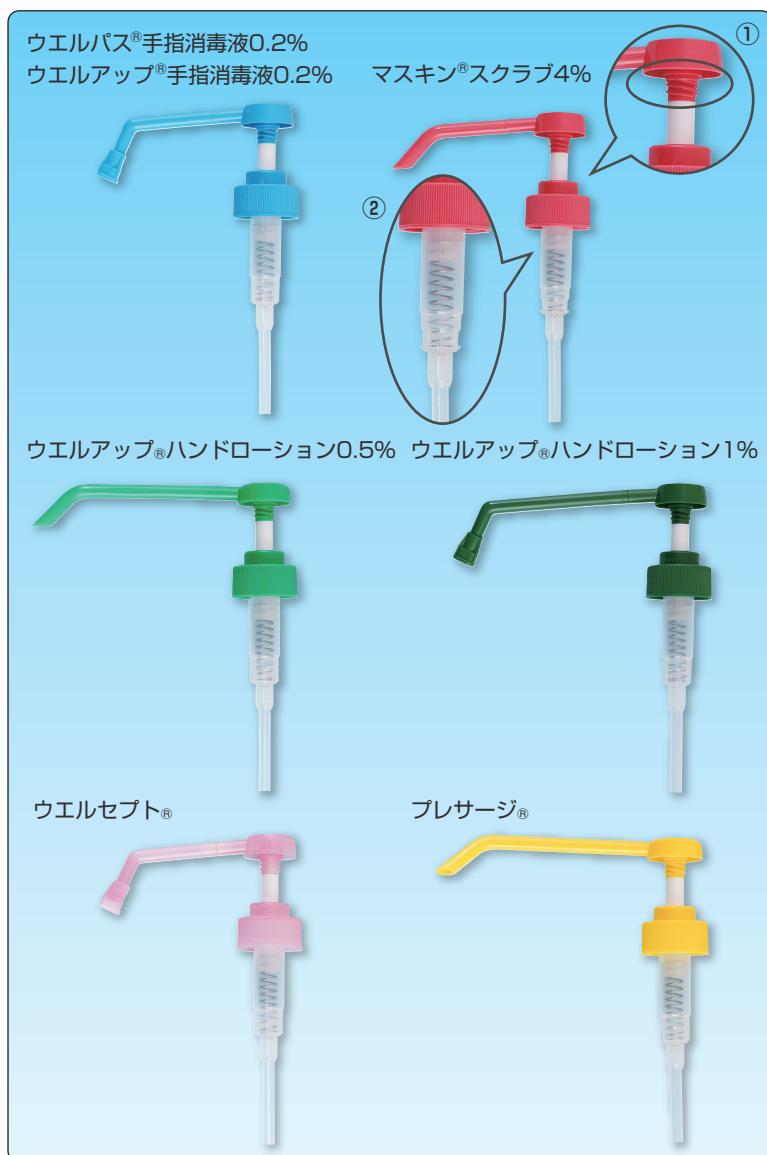

変更品

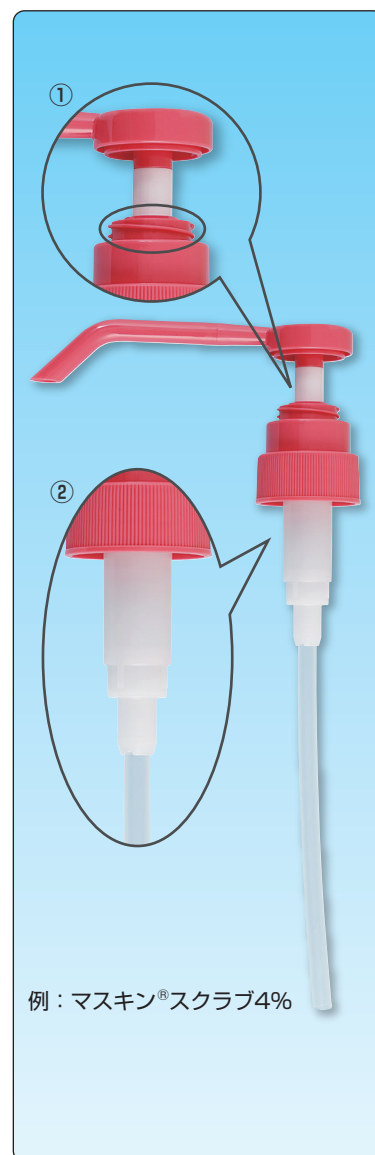

裏面もご覧ください

【対象製品・出荷予定時期】

統一商品コード	品名	包装	製造番号	出荷予定時期
211-560423	ウエルパス®手指消毒液0.2%	300mL	未定	未定
211-560430	ウエルパス®手指消毒液0.2%	500mL	未定	未定
211-560447	ウエルパス®手指消毒液0.2%	1L	未定	未定
211-563042	ウエルセプト®	300mL	未定	未定
211-563011	ウエルセプト®	500mL	未定	未定
211-560577	ウエルアップ®ハンドローション0.5%	500mL	未定	未定
211-560584	ウエルアップ®ハンドローション0.5%	1L	未定	未定
211-560591	ウエルアップ®ハンドローション1%	500mL	未定	未定
211-560607	ウエルアップ®ハンドローション1%	1L	未定	未定
211-560522	ウエルアップ®手指消毒液0.2%	500mL	未定	未定
211-560539	ウエルアップ®手指消毒液0.2%	1L	未定	未定
211-580032	マスキン®スクラブ4%	500mL	1Y162	2022年1月下旬頃
211-580049	マスキン®スクラブ4%	1L	未定	未定
211-589134	プレサージ®	500mL	未定	未定

※出荷状況により変更時期が多少前後することがございます。

各品目ごとのご案内文書は作成いたしませんので、ご了承ください

また当分の間、新旧製品が市場に流通しご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます

▶未定の製造番号・出荷予定時期につきましては、確定次第

弊社ホームページ(<https://www.maruishi-pharm.co.jp/medical/>)にてお知らせいたします。

以上