

オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」

資材変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」につきまして、遮光袋を下記のとおり変更いたします。(変更内容①)

また、添付文書を電子化へ移行し、ラベルの目盛り線が追加(変更内容②)になりますのでお知らせ申し上げます。今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

対象製品 オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」 2mL×5シリンジ

変更内容① 遮光袋の仕様変更および遮光袋・個装箱の表示変更

変更理由：2022年2月使用上の注意改訂のお知らせに伴う変更

「20.取扱い上の注意」



改訂前…本剤は光により着色するので、包装開封後も遮光袋に入れて保存すること。
着色したものは使用しないこと。

改訂後…本剤は光により着色するので、使用直前に遮光袋から取り出すこと。
着色したものは使用しないこと。

従来品



変更品

【遮光袋】

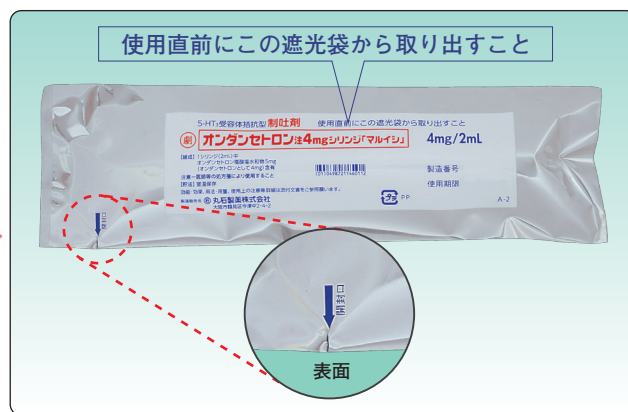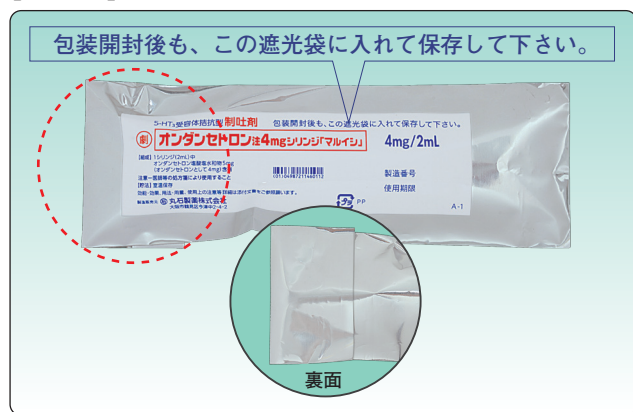

実際の製品には赤い丸印は付いておりません

【個装箱】

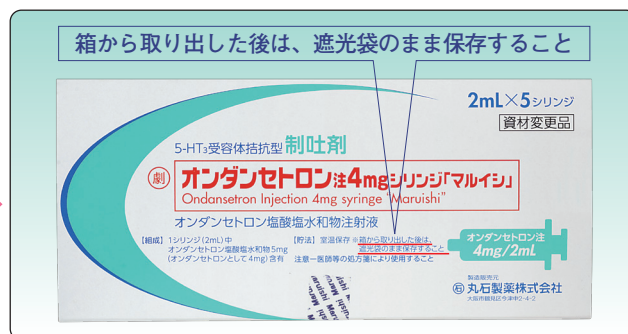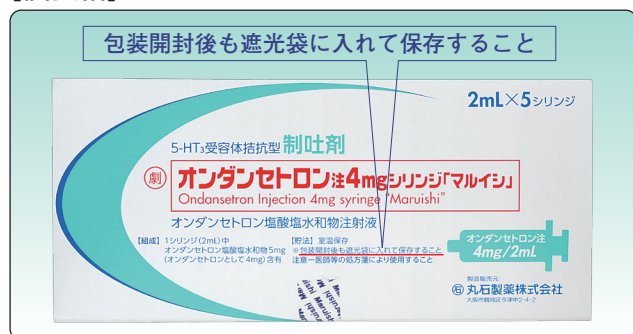

実際の製品には赤い線は付いておりません

しばらくの間、個装箱に「資材変更品」と記載します

変更内容①の出荷予定時期

統一商品コード	品名	包装	製造番号	出荷予定時期
211-360115	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	2mL×5シリンジ	1X122	2022年9月中旬頃

※出荷状況により変更時期が多少前後することがございます。

変更内容②

・添付文書の電子化

(詳細はホームページ掲載の「添付文書の電子化に関するお知らせ」をご参照ください)



https://www.maruishi-pharm.co.jp/assets/files/medical/top/denshitennbunn_oshirase_202112.pdf

・ラベルの目盛り線を追加

従来品

変更品

【ラベル】

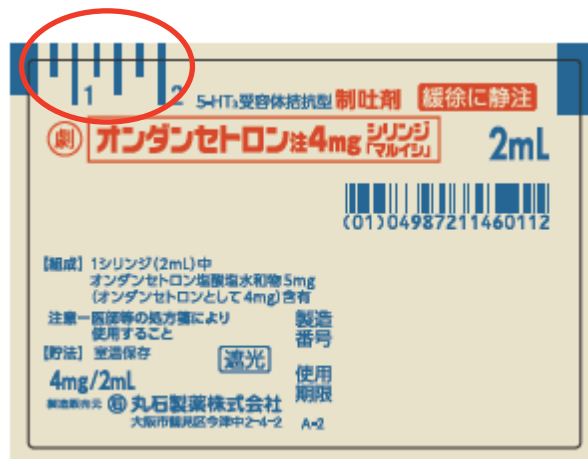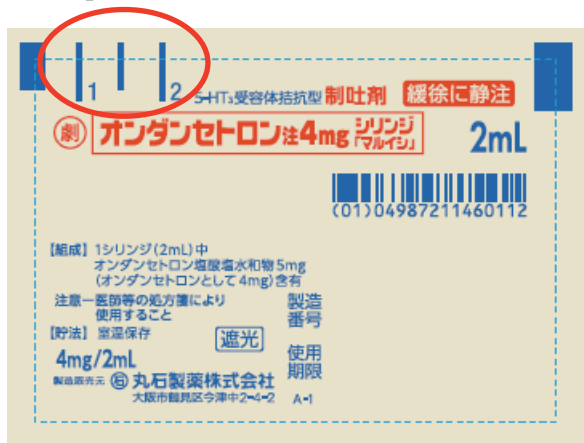

しばらくの間、個装箱に「資材変更品」と記載します

変更内容②の出荷予定時期

統一商品コード	品名	包装	製造番号	出荷予定時期
211-360115	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	2mL×5シリンジ	21242	2022年11月中旬頃

※出荷状況により変更時期が多少前後することがございます。

以上